

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU SEDİMANASYON TÜPÜ ALIM İŞİ

27.05.2016

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Seyit Ali Völkan POLATKAN  
Yönetici

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	SEDİMANASYON TÜPÜ	2.000	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **01.06.2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 HAFTA İÇERİSİNDE HASTANE SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ  
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184  
FAX: 0472 616 1168  
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

26.05.2016

**T. C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İLİ PATNOS DEVLET HASTANESİ**  
**SEDİMENTASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

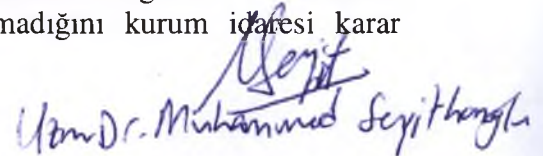
**A-KONU:** Patnos Devlet Hastanesi biyokimya laboratuvarı için temin edilecek 2000 adet sedimentasyon tüpü ve tüplerle birlikte verilecek tüplerle uyumlu 10 tüplük 1 adet sedimentasyon ölçüm sehпасı alımına ilişkin hususları kapsamaktadır.

**B- ÖZELLİKLERİ:**

1. Tüm tüpler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşınmalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
2. Satın alınacak sedimentasyon tüpleri kendinden sitratlı olup, toplam 2 ml hacmi geçmemelidir.
3. Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre siyah renkte olmalıdır. Tüp üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır.
4. Tüplerle birlikte teklif edilen tüplerin manuel kullanımına uygun olmak kaydıyla sedimentasyon sehпасları gerekli tüm malzemelerle (zaman ayarlı çalar aparat) birlikte verilmelidir.
5. Ölçüm skalası 1-140 mm/saat olmalıdır.
6. Tüpler vakumlu olmalıdır. Hastanemizde kullanılan vakumlu kan alma sistemi ile uyumlu olmalıdır. Üzerinde kan alabileceği sınırı gösteren işaret olmalıdır. Vakumların ayarı rakıma bağlı basınç farkı gözetilerek yapılmış olmalıdır.
7. Tüplerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktır.
8. Tüplerin açık ucu, içindeki vakumu koruyacak şekilde lastik veya kauçuk tıpa ve bunun üzerinde koruyucu kapak ile kapatılmış olacaktır. Vakumlu tüpün çekmesi gereken minimum kan miktarı, tüp üzerinde alt sınır çizgileri ile belirtilmiş olmalıdır.
9. Tüplerin üzerinde kaç ml kan çekeceği, sodyum sitrat oranı bulunmalıdır.
10. Tüpler tek kullanımlık ve orijinal ambalajında olmalıdır.
11. Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
12. Tüplerin uygunluğuna biyokimya uzmanı tarafından denenip onay verilecektir.
13. Ürünlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır ve teklif veren firmalar tarafından bu kaydı gösterir belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır. Söz konusu belgeleri olmayanlar ihale dışı kalacaktır.
14. Tüplerin CE belgesi olmalıdır.
15. Sonuçlar mm/saat olarak westergreen korelasyonunda ifade edilmelidir.

**C.EĞİTİM**

Sedimentasyon tetkikini çalışacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır. Eleman sayısının belirlenmesi ve verilen eğitimin yeterli olup olmadığını kurum idaresi karar verecektir.

  
Uzm.Dr. Muhammed Seyithonglu