

927

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

## TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ RÖNTGEN BİRİMİNE YAPILACAK OLAN DİJİTAL MAMOGRAFİ CİHAZININ KURULUMU İÇİN GEREKLİ OLAN ODANIN KURŞUN KAPLAMASI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 27/12/2017 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTANEMİZ RÖNTGEN BİRİMİNE YAPILACAK OLAN DİJİTAL MAMOGRAFİ CİHAZININ KURULU İÇİN GEREKLİ OLAN ODANIN KURŞUN KAPLAMASI 355 CM BOYUNDA 29 CM ENİNDE 32CM YÜKSEKLİĞİNDE	ADET	1		

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

## NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:



Doç.Dr. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİ

**MAMOGRAFI CİHAZ ODALARININ RADYASYON GÜVENLİĞİ GEREĞİ KURŞUN KAPLAMASI İŞİ ŞARTNAMESİ**


**Konu :** Mamografi cihazları odalarının TAEK Radyasyon Güvenliği Standartları Gereği Kurşun Kaplama yapılması işi şartnamesidir.

- 1- Mamografi cihazı odaları yerden 2mt. Yüksekliğe kadar 1mm. kalınlıkta kurşun plaka ile döşenecek ve aynı şekilde mevcut oda giriş kapısı 1mm kurşun plaka ile izole edilecektir.
- 2- Kapının değişmesi halinde kasası ile beraber yenisi ile değiştirilerek izole edilmiş olarak yerine takılacaktır.
- 3- Kurşun kaplamada kullanılacak kurşun plakalar en az %99.50 saflıkta ve yırtık delik olmayacak ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Kurşun plakalar için KOSGEB analiz raporu ve TSE belgesi verilecektir.
- 4- Kurşun levhaların üzeri alçıpan levhalar ile tavana kadar kaplama yapılacak olup, alçıpan üzeri alçı çekilerek idarenin seçtiği renge boyanacaktır.
- 5- Mamografi odaları havalandırması duvar tipi kapaklı emiş aspiratörü ile takılacak, aspiratör en az saatte 1000 m3 emiş yapabilecektir. Röntgen odası emiş havalandırması yerden en fazla 30 cm. yüksekliğe konulacaktır.
- 6- Oda bina ortasında veya toprak seviyesi altıda olması halinde havalandırma kanal tipi emir aspiratörü yapılacaktır.
- 7- Cihaz için gerekli olan 4x6 lık enerji kablosu mevcut kat veya ana panodan cihaz odasına kadar kablo kanalı içerisinde çekilecek.
- 8- Yapılacak olan iş Radyasyon Güvenliği işi olduğu için teklif veren firmaların Radyasyon Güvenliği ve Standartları gereği Kurşun Kaplama işi yaptığını dair ISO-9001 2008 belgesi ve iş deneyim belgesi olacaktır.
- 9- Yüklenici TAEK tarafından lisan incelemesi sırasında eksik veya kusurların olması halinde eksik veya kusurları gidereceğine dair yazılı taahhütname verecektir.
- 10- Teklif verecek firmalar yapılacak olan işi yerinde görececek ve yeri gördüğüne dair yer gördü belgesi teklif ekine ilave edilecektir. Tutanak alınmakla beraber ölçü sorumluluğu tamamen teklif veren firma sorumluluğunda olacaktır.
- 11- Mamografi Cihazının ve odalarının Türkiye Atom Enerjisi kullanım işletme lisans alınması işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacak olup, ödemesi gereken ücretler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 12- Şartnamede istenilen belgeleri veremeyen ve yer gördü belgesi almayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Radyoloji Teknikeri

Özgür BIYIKLI

MAMOGRAFİ ODASI

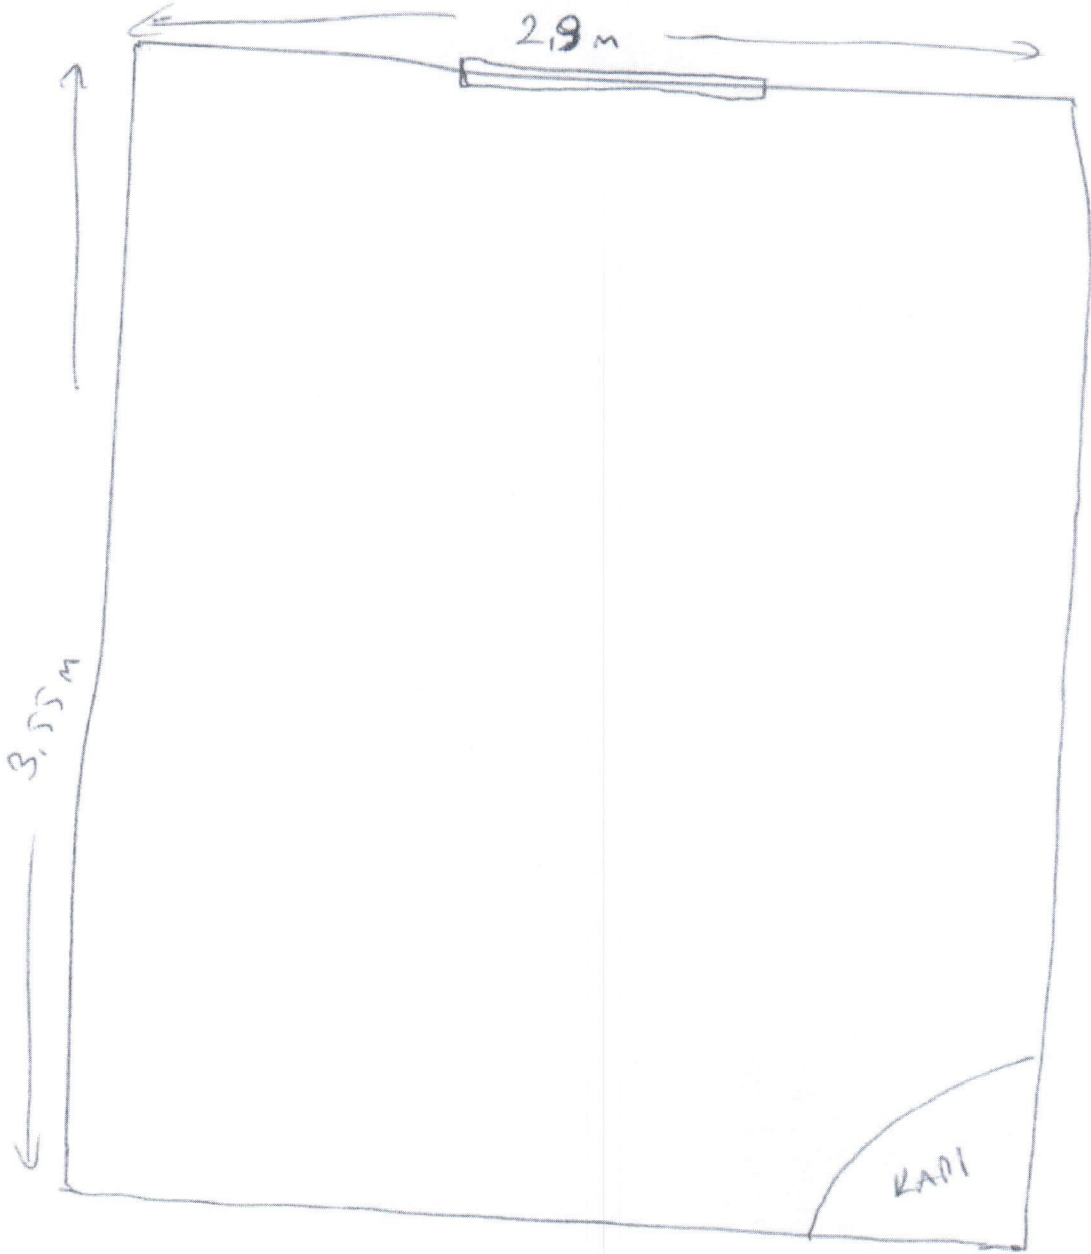

YÜKSEKLİK 3,2 metre

Rat. Tek.

Özge Büyükel