

345

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **BALON DİLATASYON SİSTEMİ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 23/02/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BALON DİLATASYON SİSTEMİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uz.Dr.Hasan BALABAN



NOTLAR:

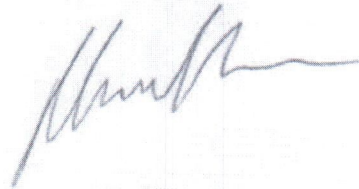
- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

EK-1

### BALON DİLATASYON SİSTEMİ

1. Balon dilatasyon sistemi, balon dilatasyon kateter ve dilatasyon kılavuz kateter olmak üzere iki ana enstrümandan oluşmalıdır.
2. Balon kateter ve Kılavuz Kateter ayrı ayrı steril ambalajda bulunmalıdır.
3. Balon'un çapı 6 mm. Uzunluğu 24 mm. olmalıdır.
4. Balonun proksimal ucunda 2mm kalınlığında siyah renkli endoskopik marker bulunmalıdır.
5. Balon kateterin balon bölümü özel olarak Polyrethane malzeme ile kaplı olmalıdır.
6. Balon non-compliant özellikte olmalıdır, 10 ATM -12 ATM basınçta belirtilen çap kalınlığı olan 6 mm yi aşmamalıdır.
7. Balon kateterlerin üzerinde balonun kalınlık ve boy ölçüleri yazmalıdır.
8. Balon kateter balonun şişirilebilmesi için inflation aletine bağlanabileceği 1 adet arka bağlantıya sahip olmalıdır.
9. Kılavuz Kateter, orifize ulaşmak için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır ve 70 derece açığa sahip olmalıdır.
10. Kılavuz kateter Floroskopi cihazı ile çalışıldığında Floroskopi ekranında görünür özellikte olmalıdır.
11. Kılavuz kateterin dış yüzü kaygan teflon malzeme ile kaplı olmalıdır.
12. Kılavuz uç kısmındaki radyopak bölüm mavi bir işaretleyici ile işaretli ve atravmatik özellikte olmalıdır.
13. Kılavuz kateterin uç kısmındaki radyopak bölüm flexible olmalıdır.
14. Kılavuz kateter in shaft bölümünün dış kalınlığı 4,5 mm den çok olmalıdır.
15. Kılavuz kateter üzerinde uç açısını belirten yazılar olmalıdır.
16. Ürünler tek elle çalışmaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır.

  
Mehmet Murat Kucuk