

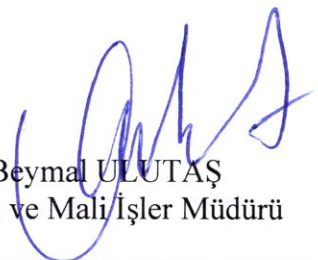
T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 517  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

02/11/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/11/2018 tarih ve saat 11:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	THERA BAND SETİ	ADET	1		
2	DUMBELL SETİ	ADET	1		
3	PİLATES SETİ	ADET	1		
4	EGZERSİZ METİ	ADET	1		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**


**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

### THERA BAND SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bantlar sporcuları dirençli egzersiz ve rehabilitasyon hastaları için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Bantlar lateks ten olmalıdır.
3. Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır.
5. Bantlar sekiz ayrı renkte olmalı ve her rengin direnci farklı olmalıdır.
6. Bantlar %100 uzadığında aşağıda değerlerde kuvvet uygulamalıdır.  
Sarı 1,3kg, kırmızı 1,7kg, yeşil 2,1kg, mavi 2,6kg, siyah 3,3kg olmalıdır.
7. Egzersiz bantları esnek özellikte olmalıdır.
8. Egzersiz bantları 8 değişik renk ve sertlikte 45,5 'er metre orijinal kutularında olmalıdır.
9. Alınacak malzemeler numuneler üzerinden değerlendirilecektir. Uygunluk verilmeyen malzemeler red edilecektir.

fuat Sozer DOĞRAN



## DUMBELL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. 1 set ağırlık içinde

- 0,5 kg Dumbel 1 adet
- 1 kg Dumbel 1 adet
- 1,5 kg Dumbel 1 adet
- 2 kg Dumbel 1 adet
- 3 kg Dumbel 1 adet
- 4 kg Dumbel 1 adet
- 5 kg Dumbel 1 adet

2. Dumbıllar metal üzeri vinil kaplı dumbell olmalıdır.
3. Dumbılların görünebilir yerinde ağırlık kg'ları yazılı olmalıdır.
4. Dumbeller kolay ayırt edilmesi için her ağırlığın rengi farklı olmalıdır.
5. Alınacak malzemeler numuneler üzerinden değerlendirilecektir. Uygunluk verilmeyen malzemeler red edilecektir.

Prof. Söğüt Dönem

### PİLATES SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Rehabilitasyon topları gövde egzersizleri ve rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
2. Rehabilitasyon toplarının üzerine basınç bindiği zaman dereceli olarak artan bir direnci olmalıdır
3. Rehabilitasyon toplarının kullanıcının amacına ve boylarına uyumlu olması için çapı 18-22-26 cm den 1 er adet olmalıdır.
4. Toplar şişmiş olarak teslim edilmelidir.
5. Alınacak malzemeler numuneler üzerinden değerlendirilecektir. Uygunluk verilmeyen malzemeler red edilecektir.

Dr. Sözer DOĞAN

### EGZERSİZ METİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz fizik tedavide üzerinde hasta egzersizi yaptırılabilir şekilde üretilmiş olmalıdır.
2. Cihaz uzun süre kullanım için sert gri dansitesi yüksek 30 cm 'ilk çabuk deforme olmayan süngerden yapılmış olmalıdır.
3. Cihazın üzeri sağlam çabuk deforme olmayan vinil ile döşenmiş olmalıdır.
4. Cihaz hasta ve terapistin rahat çalışabilmesi için en az 120 cm X 190 cm ölçülerinde olmalıdır.
5. Egzersiz meti üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- 6.
- 7.
- 8.
9. Alınacak malzemeler numuneler üzerinden değerlendirilecektir. Uygunluk verilmeyen malzemeler red edilecektir

Dr. Sürer DÖĞAN