

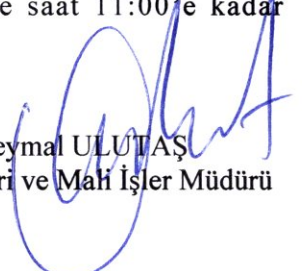
T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ ¹⁰⁸
Konu : Mal Alımı

29/03/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatınının 01/04/2019 tarih ve saat 11:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BUZDOLABI (SOĞUK ZİNCİR İLAÇLARIN MUHAFAZASI İÇİN/DERİN DONDURUCULU)	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.
- 10-Kısmi teklifler kapalıdır.


SOĞUK ZİNCİR İLAÇ DOLABI

Aşağıdaki teknik özelliklere rağmen, numune Eczane Birimince değerlendirildikten ve uygunluk raporu tanzim edildikten sonra alım sonuçlandırılacaktır.

1. Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac veya parmak izi bırakmayan inox renk seçeneğine sahip ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
3. Cihaz iki farklı fonksiyona sahip hem +2/+8 arası hem de -10/-20 arası saklama yapılmasını sağlayacak şekilde çift katlı olmalıdır.
4. Cihazın kapı sistemi çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve sızdırmazlık sağlayan manyetik conta, Derin dondurucu bölümü yüksek yoğunlukta üretilmiş poliüretan dolgu yalıtıma sahip blok kapı sistemine sahip olmalıdır.
5. Cihaz güçlü fan sistemiyle eşit ısı dağılımı yaparak soğutma sağlanmalıdır. Teslimat sırasında cihazın her tarafta eşit ısı dağılımı yaptığı belgelenecektir. Bu iş için cihazın ısı dağılımı haritası çıkartılıp teslimatta verilmelidir.
6. Dolap içi raf sistemi (en az 3 raf) paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş, hava sirkülasyonunu hızlandıran ergonomide dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Derin dondurucu izolasyonu, yüksek yoğunlukta elde edilmiş poliüretan malzeme ile sağlanmalıdır.
8. Derin dondurucu sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır. Dolabın aydınlatması led veya floresan lamba ile olmalıdır.
9. Dolap iç hacmi en az 230 ±20 Litre, Dondurucu iç hacmi 50±10 olmalıdır.
10. Dolap ısıları en az 30 gün boyunca dijital kart üzerinde saklanmalı ve RS 232 port çıkışıyla P.C ye aktarılabilme işlemi yapmalı veya Hastane de bulunan sisteme uyumlu sms ve/veya mail yolu ile günlük haftalık ve aylık rapor gönderebilen ve anlık alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında hem ses, hem görsel. hem de sms/mail yolu ile alarm bildirimini yapan ısı nem takip sistemi ile beraber teslim edilmelidir. .
11. Dolap üzerinde kolay kullanılabilen mikro işlemcili dijital kontrol paneli bulunmalıdır.
12. Dolap sıcaklık bilgisinin, istenildiğinde bilgisayar ortamına aktarımını sağlayan RS 232 port bulunmalıdır.
13. Dolabın derin dondurucu kısmı -10° ile -20° sıcaklığı, dolap kısmı+2°/+8° sıcaklığı %5 hassasiyette ayarlayabilmelidir.
14. Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir.
15. Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi olmalıdır. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 72 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.
16. Cihazın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemelidir.
17. Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmalıdır.
18. Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye yetkili temsilcisi olduğuna dair distribütörlük belgesini teklifine eklemelidir.

Dr. Zeynep YARDIMCI
Dip. Tes. No: 42611
Ağrı Devlet Hastanesi

19. Cihazın elektriksel güvenlik testleri kalibrasyon sertifikasına sahip ölçüm cihazları ile yapılmalıdır. Cihazın elektriksel güvenlik testleri, toprak iletken direnci ve izolasyon direnci ölçüm bilgilerini içermelidir. Yetkili kurucu teknik servis tarafından ölçüm bilgileri yapılmalı ve kullanıcıya teslim edilmelidir.
20. Cihaz TSE ve/veya CE sertifikalı olmalıdır.
21. Cihaz hastaneye kurulduktan sonra bir hafta test edilip teknik servis ve kullanıcı birim sorumluları tarafından onaylandıktan sonra mal kabulü yapılacaktır.
22. Cihazın kurulumu için gerekli tüm gerekli malzeme (kablo, UPS priz, ağ kablosu vbg..) ihaleyi alan firma tarafından, işçilik hastanemiz tarafından sağlanacaktır.
23. Dolap fabrikasyon hatalarına karşı 2 (iki) yıl ücretsiz, 5 yıl kompresör garantisi, takip eden on yıl için ücreti karşılığında yedek parça ve servis, garantisine sahip olmalıdır.
24. Firma Cihazın kalibrasyonunu geçerli sertifika ve yetkiye sahip bir firmaya yaptırmalı ve test sonuçlarını cihaz ile beraber teslim etmelidir. Ayrıca 2 yıl boyunca yılda bir kez ve arıza oluştuğunda onarımı takiben ücretsiz kalibrasyonunu yaptırmalı/yenilemelidir.


Z. Zeynep YARDIMCI
Dip. Teş. No: 42611
Ağrı Devlet Hastanesi