



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

09.12.2019

Sayı : 458
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1436

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.12.2019 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.No	Satın Alınacak Malın/ İşin Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	KDV Hariç Teklif	
					Fiyat	Tutar
1	SİNİR STİMÜLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU PLEKSUS ANESTEZİ KANÜLÜ 22G 80 MM		150	Adet		
2	SİNİR STİMÜLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU PLEKSUS ANESTEZİ KANÜLÜ 22G 50 MM		100	Adet		
3	SİNİR STİMÜLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU PLEKSUS ANESTEZİ KANÜLÜ 20 G 100 MM		100	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

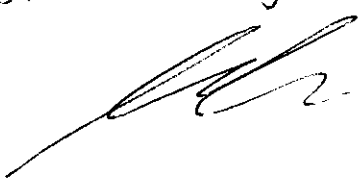
Alım kısmi teklife kapalıdır.

DEVAMLI PLEKSUS ANESTEZİ KANÜLÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ponksiyon kanülü Özel izole edilmiş Nano Line yalıtkan kaplı olmalıdır.Emin sinir lokalizasyonu için İğnenin ucundan tek noktadan ileti vermelidir.
2. Ponksiyon kanülünün iç yüzeyide aynı şekilde özel yalıtkan kaplı olmalıdır,bu şekilde anestezik maddelerin geçişinide kolaylaştırmalıdır
3. Ponksiyon kanülü, düzgün üst yüzeyli olmalıdır.
4. Ponksiyon kanülünde derinliği gösteren uzunluk işaretleri olmalıdır.
5. Emin sinir lokalizasyonu için ince atravmatik uçlu olmalıdır.
6. Kanul kaplaması sayesinde ultrason altında görülebilir özellikte olmalıdır
7. Ponksiyon kanülünde enjeksiyon / aspirasyon için kullanıma uygun uzatma line'li olmalıdır.
8. Ponksiyon kanülü değişik çap ve uzunluklarda(22 derece) olmalıdır:

Faset Uç		Sprotte uç	
Çap:	Uzunluk	Çap:	Uzunluk:
22G	80mm		
21G	100mm		
20G	120 veya 150mm		

9. Set içerisinde kanulun içerisinden geçirilebilen ve anestezinin devamlılığını sağlayan polylamid den imal edilmiş bir kateter,kateter le birlikte kullanılacak filtre ve ketere bağlanmaya yarayan adaptörü de bulunmalıdır
10. Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
11. Kanül mevcut stimulatör ile uyarılabilir olmalı ve /veya 1 adet stimulatör cihazı beraberinde yardımcı aparatları ile verilmelidir.
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
13. CE Sertifikasına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

D. Hareli E. E. E. E. E.


Rahim ALTUN
Anestezi Sorumlusu
Ağrı Devlet Hastanesi

