



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 647
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Yetişkin Acil Triaaj Odası İçin Pvc Alüminyum Çerçeve Yapım İş
Dosya Id : 2088

24.03.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.03.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	YETİŞKİN ACİL TRIAJ ODASI İÇİN PVC ALÜMİNYUM ÇERÇEVE YAPIM İŞİ (610CMX270CM)			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın Alınmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Devlet Hastanesi

YETİŞKİN AÇIL TİRİAJ ODASI PVC ALİMİNYUM YAPIM İŞİ

ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (kalem) pvc aliminyum çerçeve camlı yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Talep edilen pvc aliminyum çerçeve camlı 610cm x 270 cm olacak


3. GARANTİ;

3.1 Sözleşmeye konu olan iş, en az 2 yıl garantili olacaktır.


4. KABUL;

4.1 Kabul hastane teknisyenlerinin bulunduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

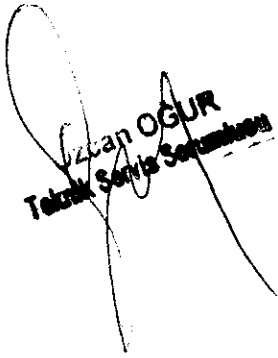
Özcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu

270 cm

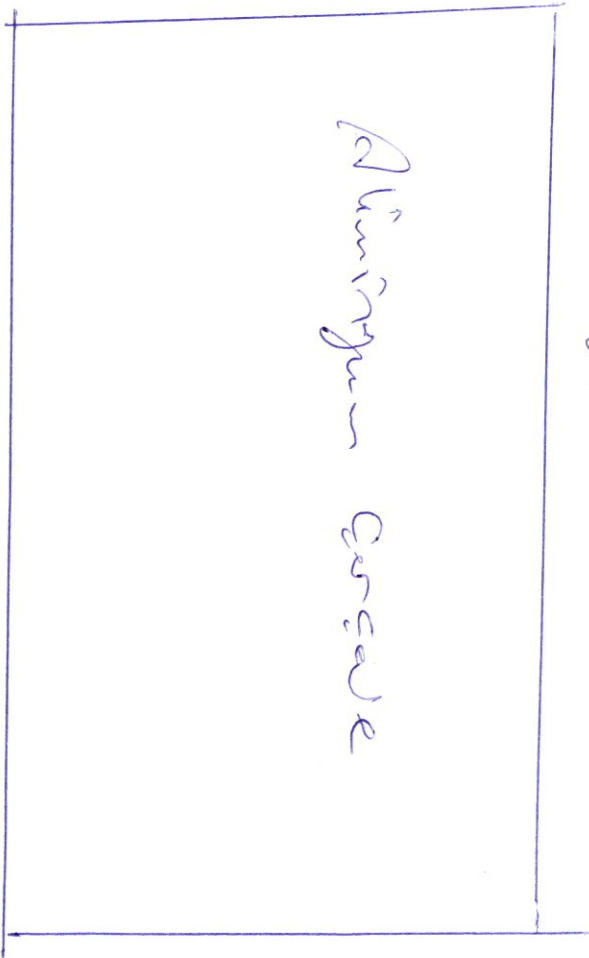

610 cm

Alüminyum Çerçeve

270 cm

610 cm

ÖZCAN OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu