

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL KİMLİK KARTLARININ BASIM İŞLEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Personel kimlik Kartları RFID Teknoloji kullanılarak kurumumuzda mevcut çalışan akıllı kart ve uygulamalarıyla da uyumlu çalışabilmesi sağlanması amaçlanmıştır.

alımı yapılacak olan ürün sayısı aşağıdaki gibi olacaktır. Teklif verecek firma "Distribütörlük / Yetkili Satıcılık Belgesi" teklif mektubu ile vermelidir.


Sıra	Açıklama	Miktar
1	Ribon	5 (beş)Adet
2	Personel Kimlik kartı	1000 (Bin) Adet

1. Sarf Malzemelerinde Bulunması Gereken Teknik Özellikler:

- Kurum bünyesinde kullanılan kart yazıcılar ile uyumlu olmalıdır.
- Ribonlar ile ön yüze renkli arka yüze siyah 250 Kart/Baskı yapabilmelidir.
- Yazılarda bulunan otomatik ribon algılama özelliği doğrultusunda otomatik tanınmalıdır.
- Ürün ambalajları 57mmx83mmx1240mm ölçülerinde olmalıdır.
- Ürün ambalajlarında üretici güvenlik bandı bulunmalıdır.
- Ürün ambalajlarında 1 Adet Ribon ve 1 Adet Temizleme merdanesi bulunmalıdır.
- Ürünler içinde yazıcı tarafından otomatik tanımayı sağlayan RFID Tag bulunmalıdır.
- Ürünler dış etkilerden korunmak amacıyla PP paket içinde bulunmalıdır.
- 0-30°C aralığında sorunsuz saklanmalı ve çalışmalıdır.
- Ürünler orijinal olmalı ve belgelenebilmelidir.
- Ürünler orijinal Koli ve ambalajlarda teslim edilmelidir.
- Magicard ENDURO + uyumlu olmalıdır

2. Personel Kimlik Kartının Teknik Özellikleri

- Ön ve arka baskılı olacak
- 54x86mm ebatlarında olacak
- 760 Micron kalınlığında
- Proximity 4100 EM Kontaklı Akıllı Kart
- Sağlık Bakanlığı politika ve prosedürlerine uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Görsel onaya müteakiben basım yapılacaktır.
- Personel Kimlik Kartının görseli ekte mevcuttur.

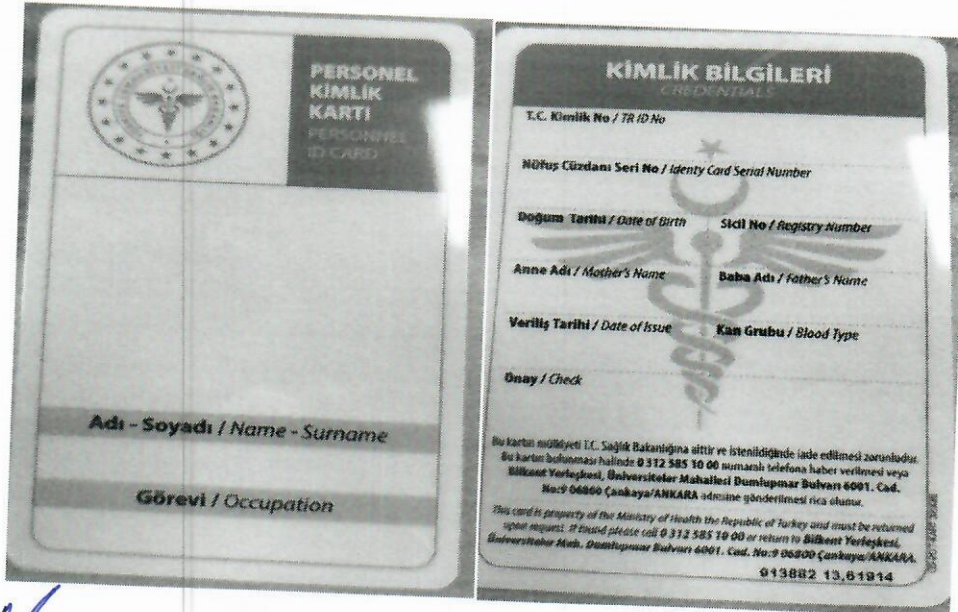

Ahmet MAĞAL
Sağlık Bilgi Sistemleri
Bölmü Başkanı

Ayhan KAYA
Sağlık Bilgi Sistemleri

Melik ASLANGİRİ
Bilgisayar Teknisyeni