

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### BEZ ÇANTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bez çanta boyutları 35x40 cm ( $\pm$  0,5 cm) olmalıdır.
2. Kulp uzunluğu 2,5x70 cm ve siyah renkli olmalıdır.
3. 200 gr ağırlığında olmalıdır ve %100 pamuk ham bez kumaş ve dikişli olmalıdır.
4. Çift yön ve renkli transfer toz baskı olmalıdır.
5. Kalım ve notluk iç cepli dikişli olmalıdır.
6. Çantanın her iki yüzüne yapılacak baskı idare tarafından belirlenecek, numune idare tarafından onaylandıktan sonra üretime geçilecektir.
7. Basım başlamadan önce 1 adet örnek merkezimize getirilerek onay alınmalıdır.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

### ŞAPKA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şapkalar kumaştan, cırt bantlı, kuşgözü, köpük siper bulunacak şekilde olmalıdır.
2. Üç ayrı beden seçeneği olmalıdır.
3. Kullanılan tekstil ürünlerinin (kumaş ve boya) insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermediği belgelenecektir.
4. Ürünlerin görünür hiçbir bilgesinde gerek yüklenici gerekse üretici logo ve amblemi bulunmayacaktır.
5. Baskı için transfer baskı kullanılacak, güneşe ve suya dayanıklı yıpranmaz ve renkleri solmaz bir kalite ile dikilecek ve bastırılacaktır. Şapkanın üst tarafına baskı gelecektir.
6. Tüm ürünlerin üzerlerine yapılacak baskı tasarımı ve renk seçimi müdürlük tarafından yapılmış olan seçimlerin dışında olmayacaktır.
7. Numune idare tarafından onaylandıktan sonra üretime geçilecektir.
8. Basım başlamadan önce 1 adet örnek merkezimize getirilerek onay alınmalıdır.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### TANITIM BROŞÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. A 4 boyutunda kuşe kağıda olmalı
2. Orta kısım ön yüzünü oluşturmak üzere üçe katlanılır olmalıdır.
3. Çift taraflı olmalı
4. 500 adet olmalı
5. 1.Sınıf basım olmalı
6. Renk gönderilen taslaktaki gibi olmalı

Basım başlamadan önce 1 adet örnek müdürlüğümüze getirerek onay alınmalı


<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------



## HAKKIMIZDA

Sađıđıa y6nelik risklerden birey ve toplumu korumak, sađlıklı hayat tarzını teřvik etmek, birinci basamak sađlık hizmetlerini g6çlendirmek ve bu hizmetlere ulařımı kolaylařtırmak amacıyla hizmet vermekte olan sađlık kuruluřuyuz.

Kurumumuzdaki verilen hizmetler  
6cretsizdir.

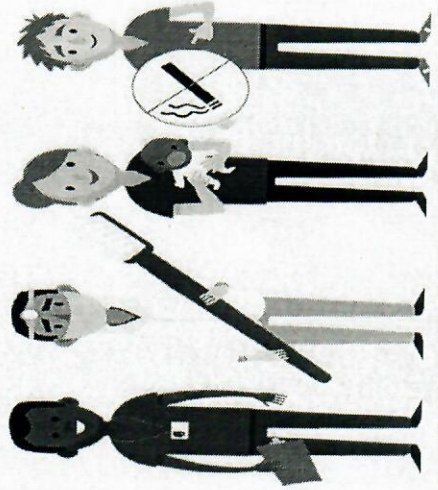

## Sađlıđınız iin alıřıyoruz...



AİLE HEKİMLİĐİ DEĐİŐİKLİĐİ TALEBİNDE  
BULUNABİLİRSİNİZ.

## Bize Ulařın

Adres: Atat6rk Mahallesi İn6n6 Caddesi No:118

Diyadin/AĐRI

Tel: (0472) 511 4650

e-mail: tsm.diyadin@gmail.com

T.C

SAĐLIK BAKANLIĐI

AĐRI İL SAĐLIK M6D6RL6Đ6

DİYADIN İLE SAĐLIK M6D6RL6Đ6



DİYADIN İLE SAĐLIK  
M6D6RL6Đ6  
TANITIM BROŐUR6



### HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hastalarımızın dilek, öneri ve şikayetlerini rahatlıkla bildirebilmeleri için müdürlüğümüze başvurabilirsiniz. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 1 ve 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezleri'nde birer adet dilek öneri kutusu bulunmaktadır.

### KETEM BİRİMİ

- 30-65 yaş grubundaki kadınlarda Rahim ağzı kanser tarama testi
- 50-70 yaş arası kalın bağırsak kanseri tarama testi
- 20 yaş üstü kadınlara meme muayenesi yapılmaktadır.

### KADIN ÜREME SAĞLIĞI VE DAYANIŞMA BİRİMİ

Evlilik öncesi danışmanlık ve gebe sınıfında düzenli eğitim verilmektedir.

### DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

İmmobil (yatalak) hastaların ambulans sevkleri ile vatandaşların rapor itiraz talepleri alınıp ilgili kurumlara bildirilmektedir.

### HİZMETLERİMİZ

- Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Danışmanı Birimi
- Meme Kanseri Taraması
- Rahim Ağzı Kanseri Taraması
- Kalın Bağırsak Kanseri Taraması
- Hasta Hakları Birimi
- Kadın ve Üreme Sağlığı Dayanışma Birimi
- Üreme Sağlığı Danışmanlığı
- Gebe Bilgilendirme Sınıfı
- Evlilik Öncesi Danışmanlığı
- Çevre Sağlığı Birimi
- Toplum Sağlığı Birimi
- Okul Çağı İşitme Tarama Programı
- Okul Çağı Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı
- Sağlıklı Beslenme Eğitimi Programı
- Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
- Aşı Birimi
- Destek Hizmetleri Birimi
- Obezite Birimi
- Aile Hekimliği Birimi



### ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri; üretim, dağıtım ve satış yerlerinin denetimleri ile su numunesi alınıp gerekli analizleri yapılmaktadır.

### TOPLUM SAĞLIĞI BİRİMİ

Okul sağlığının korunması, geliştirilmesi için öğrencilere düzenli eğitim verilmekte, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine işitme tarama testi yapılmaktadır.



### AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

Aile Hekimlerinin saha çalışmalarını; gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin planlanması ve takip edilmesi sağlamakta olup vatandaşın istediği hekimi seçme işlemleri yapılmaktadır.

### BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ

Bulaşıcı Hastalıklar ile ilgili verilerin toplanması, analizi, geri bildirimlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarını yürütüp bu konularda halka eğitim verilmektedir.



## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### GLUKOSTİK ( STRIP ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Garanti belgesi olmalıdır.
2. Stripler Glukometre ile uyumlu olmalı, kod okutmaya gerek duyulmamalıdır.
3. Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilir.
4. Striplerin son kullanım tarihi her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde olmalıdır.
5. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalıdır. İhaleyi kazanan firma mevcut striplerin kullanılmaması durumunda son kullanım tarihine en az üç ay kala durumun firmaya yazılı olarak bildirilmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirme garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir.
6. Ölçüm sonuçları tutarlı, klinik bulgular ile uyumlu olmalıdır.
7. Stripler 15-40 C sıcaklıkta güvenilir sonuçlar vermelidir.
8. Striplerin ölçüm aralığı en az 20-600 mg/dl arasında olmalıdır.
9. Stripler kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal tam kan örneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir.
10. Striplerde görsel kontrol de mümkün olmalıdır.
11. Stripler %20-70 hematokrit aralığında güvenli sonuç vermelidir.
12. Stripler 2 mikro litre gibi çok az bir kanla çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Striplere kan damlatıldıktan sonraki en geç 10 saniye gibi kısa sürede cihaz kan şekeri sonuçlarını ekranında verebilmelidir.
14. Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
15. Kan scribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.
16. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir. İnce olmamalı, kırılıp bükülmemelidir.
17. Stripler nem, ısı ve ışıktan korunaklı ambalajlarda olmalıdır.
18. Stripler tek tek ambalajlanmışsa en fazla 100 adetlik, tek tek ambalajlanmamışsa en fazla 50 adetlik paketler halinde olmalıdır.
19. Her 500 strip başına bir glukometre cihazı verilmelidir. Cihaz stripler ile uyumlu olmalıdır.
20. İhale süresine bakılmaksızın ölçüm çubukları bitinceye kadar, cihazların bakım, onarım ve pil değişimi firma tarafından yapılacaktır.
21. Numuneler ihale esnasında, getirilip birim tarafından denedikten sonra karar verilecektir. Numune getirmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22. Titubb (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) Barkod Sut ve Sut alan kodlarından kaynaklanan zararlar ve kesintiler yüklenici firmaya aittir.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık en az (30 g) uçlu ince tip olmalıdır.
2. Delici metal uç plastik gövdeye yerleştirilmiş olmalı ve delici uç ayrı bir plastik parça tarafından korumalı olmalıdır.
3. 100 lük ambalajlarda olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
5. Uç delici kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.
6. Ürün CE belgeli olmalıdır.
7. Otomatik delici lanset kalemlere uyumlu olmalıdır.
8. Ürün teslim tarihiden itibaren en az 24 ay miadlı olmalıdır. Miadı içerisinde tüketilemeyen ürün en az 3 ay öncesi bildirim yapıldığında, uzun miadlı yeni ürünle değiştirilmelidir.
9. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise belirtilmelidir.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------



## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### TIBBİ ATIK TULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Turuncu renkte olmalıdır.
2. Tulum şeklinde olmalıdır.
3. Yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır.
4. Polo yaka olmalı ve uzun düz kollu olmalıdır.
5. Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilmelidir.Ölçülere idare karar verecektir.
6. Tulum arka kısmında "ULUSLARARASI BİOTEHLİKE AMBLEMİ" İLE "DİKKAT TIBBİ
7. ATIK" yazısı baskısı olacaktır.İdarenin isteğine bağlı olarak ön kısmında üst cebin üstüne "TIBBİ
8. ATIK PERSONELİ" yazısı eklenebilmelidir.
9. Tıbbi atık kıyafeti standart tulum şeklinde hazırlanmalıdır.
10. Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup,yırtılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez olacak,tulum yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak.
11. Belde yarım lastik ,kaliteli fermuarlı olacak.
12. Kollar düz olacak.
13. İthal polyester gabardin(%65 pamuk,%35 polyester) kumaş kullanılacak.

<b>ÜYE</b>  Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b>  Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b>  Selin KOC Hemşire
--	--	---

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### TIBBİ ATIK ÇİZMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Su geçirmez olacak.
2. İğne batmaz kauçuktan olmalıdır.
3. Diz altı hizasında olmalıdır.
4. Yıkamaya ve kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
5. PVC nitril kauçuk esaslı malzemedен imal edilmiş tabanı sert kauçuktan olmalıdır.
6. Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olmalıdır.
7. İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyen yapıda olmalıdır.

<b>ÜYE</b> Melik YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------



## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### TIBBİ ATIK ELĐVENĐ TEKNĐK ŐARTNAMESĐ

1. Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuŐ özelliĐine sahip olmalıdır.
2. Yırtılmalara ve sŕtŕnmelere dayanıklı olacak.
3. Kaygan ve kaba malzemeleri ok rahat tutacak.
4. Őstŕ tamamen kaplı,i astarı kaliteli olacak.
5. Rengi turuncu olacak.
6. Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yŕksek,kullanıcıyı iĐne ve keskin materyallerden koruyucu özelliĐi bulunmalıdır.
7. Tıbbi atık eldiveni CE ve uluslararası standartlara uygunluĐu bulunmalıdır.
8. Eldivenler kaliteli kauuk malzemedен ũretilmiŐ olmalıdır.
9. Kimyasal dezenfektanlara karŐı dayanıklı olmalıdır.
10. Kaymayı engellemek iin eldivenin ũzeri tırtıklı olmalıdır.

<b>ŐYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŐKAN</b> Dr. Baran DEMĐRTAŐ İle SaĐlık Mŕdŕrŕ	<b>ŐYE</b> Selin KO HemŐire
-----------------------------------	---	------------------------------------

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### TIBBİ ATIK KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) imal edilecektir.
2. Konteyner TS EN 840 Standardına uygun olacaktır.
3. Konteynerlerin tekerlek gövdeleri polipropilen ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartlarına dayanıklı mamülden yapılmış olacaktır.
4. Tekerlek aks mili galvaniz kaplı veya paslanmaz malzemeden olacaktır.
5. Konteyner hacmi 770-800 Lt kapasiteli olmak üzere 4 tekerlekli ve üstten kapaklı olacaktır.
6. Konteynerlerin tekerlek dönüşleri kolay olacak, genel anlamda konteyner rahat taşınabilir olacaktır.
7. Konteynerler koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, güneş ısısından etkilenmeyecek aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
8. Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak ve bu şok etkisinde hiçbir deformasyon ölçü ve diğer özelliklerinde değişiklik olmayacaktır.
9. Konteynerlerin gövdeleri düşmeye karşı dayanıklı olacak, sızma, çatlama ve yarıлма göstermeyecektir.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------



## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### 4' LÜ SIFIR ATIK KUMBARALARI VE POŞETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik 4'lü set halinde olmalıdır.
2. Atık kumbaraları cam atık, kağıt atık, plastik atık ve metal atık türleri için olmalıdır.
3. Kalın kırılmaz plastikten olmalıdır.
4. Ölçüleri 35\*35\*70 cm olmalıdır.
5. Her kutunun üstünde hangi atığın atılacağına dair yazı, geri dönüşüm simgesi ve sıfıratık logosu bulunmalıdır.
6. Kağıt atık için mavi; cam atık için yeşil; plastik atık için sarı ve metal atık için gri rengi kullanılmalıdır.
7. Kumbaraların ve poşetlerin üzerinde geri dönüşüm simgesi, sıfır atık logosu kullanılmalıdır.
8. Her kumbara rengi için 150 adet poşet alınmalıdır.
9. Atık poşetleri delinme, yırtılma durumlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Teklif veren firmadan örnek kutu istenilecek ve şartnameye uygun olmaması durumundatarafımızca kabul edilmeyecektir.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### TANITIM STANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Taşınması, demonte monte dönüşümü kolay olmalıdır.
3. İç gövdesinde 1 (bir) adet raf olmalıdır ve rafın taşıma kapasitesi 5 kg'a kadar dayanıklı olmalıdır.
4. Rengi beyaz olmalıdır.
5. Gövde ve alınlığa basımı yapılacak logo ve yazılar idareden teslim alınacaktır.
6. Plaastik oval tanıtım satndı demonte şekli PVC kumaş çanta içerisinde olmalıdır.
7. Ölçüler:
  - En: 80-100 cm
  - Derinlik: 45-50 cm
  - Boy: 90-100 cm
  - Kurulu Yükseklik: 180-200 cm
  - Alınlık: 80-100 cm
  - Alınlık Yüksekliği: 20-25 cm
  - Ağırlık: 5 kg
  - Taşıma Kapasitesi: 15 kg

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------



## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### YER MINDERİ (MAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 100(±20) x180 (±20) cm boyutlarında olmalı
2. Fermuarlı, leke tutmaz özelliği olan, dış kılıfı yıkanabilir malzemedan olmalıdır yıkanabilir.
3. İç kılıfı olmalıdır.
4. Pamuklu kumaştan yapılmış olmalıdır.
5. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
6. Rulo haline getirilerek fazla alan kaplamaması ve korunması sağlanabilmektedir.
7. Kullanıma uygun olmayan (ambalaj hatası, uygunsuzluk, kusurlu ürün vb. ) ürünler firma tarafından değiştirilebilmeli.
8. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

### TENIS TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Topun çapı 6,3-6,8 cm aralığında olmalıdır.
2. Rengi sarı veya beyaz olmalıdır.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### PILATES TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çapı 65 cm olmalıdır.
2. Yumuşak renkli, elastik malzemedен imal edilmiş olmalı
3. Pilates topları kol ve bacak egzersizleri ve rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
4. Pilates toplarının üzerine basınç bindiği zaman dereceli olarak artan bir direnci olmalıdır.
5. 24 ay garanti süresi bulunmalıdır.
6. Paket içerisinde el pompası olmalı ve bu pompa topu pratik bir şekilde şişirebilmelidir.
7. Pilates topunun delinmesi durumunda havasının yavaş yavaş inmesini sağlayacak ABS sistemi olmalıdır.
8. Toplar şişmiş olarak teslim edilmelidir.
9. Teslimat öncesinde numune görülecektir.
10. Rengi gri veya pembe olmalıdır.Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

### AYAKLI YAZI TAHTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüzeyi Emaye ve silinebilir olmalıdır.
2. Çevresi alüminyum çerçeve ile kaplanmış olmalıdır
3. 60(±10) x 90 (±10) cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Teleskopik ayaklı ve ayaklar ayarlanabilir olmalıdır.
5. Beyaz renk olmalıdır.
6. Ürün kalemleri ve silgisi ile birlikte verilmelidir.
7. Kalem ve silgi için alt tarafında yeri olmalıdır. En az 2 yıl garantili olmalıdır

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------



## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### YASTIK (KÜÇÜK/BÜYÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Büyük yastık ölçüsü 50(±10)x70(±10) cm ölçülerinde, küçük yastık ölçüsü:35(±10) x35(±10) cm olmalıdır.
2. Şilte kumaşı %100 pamuk olmalıdır.
3. Dış kılıfında fermuar olmalıdır.
4. Dış kılıfı yıkanabilir malzemeden olmalıdır.
5. Yastık içerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalıdır.
6. Ürün içerisindeki boncuk silikon elyaf, yıkama veya kullanma esnasında keçeleşme ve topaklanma yapmamalıdır.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

### BEBEK HAVLUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
2. 90(±10) x 90(±10 cm) ebatında olmalıdır.
3. Beyaz olmalıdır.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### BEBEK BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
2. 90(±10) x 90(±10 cm) ebatında olmalıdır.
3. Yıkabilir olmalıdır.
4. Ürünün kenarları 3cm'lik biye ile veya kenarları içe katlamalı şekilde çift kat olarak dikilecektir.
5. Rengi krem olmalı

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

### BEBEK MASAJ YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bebek cildi için özel olarak geliştirilmiş olmalıdır.
2. Nemlendirme sağlamalıdır.
3. Bebek masajı için kullanılabilir olmalıdır.
4. Hipoalerjenik olmalıdır.
5. İnsan sağlığına zararlı bileşen içermemelidir.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------



## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### BEBEK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Emici olmalı yanlardan sızdırma yapmamalıdır.
2. Yanlarda yapıştırma bantları olmalı açılıp kapandıktan sonra tekrar yapıştırılabilmelidir.
3. Yanları sert olmamalı bebeğin cildini tahriş etmemelidir.
4. Yenidoğan boyutlarında (3-6 kg) olmalıdır.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

### DUMBELL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 set ağırlık içinde
  - 0,5 kg dumbell 1 adet
  - 1 kg dumbell 1 adet
  - 2 kg dumbell 1 adet
2. Dumbellar metal üzeri vinil kaplı dumbell olmalıdır.
3. Dumbelların görünebilir yerinde ağırlık kilogramları yazılı olmalıdır.
4. Dumbelların kolay ayırt edilebilmesi için her ağırlığın rengi farklı olmalıdır.
5. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### EGZERSİZ DİRENÇ LASTİĞİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak, orta ve sert şeklinde 3'lü set halinde olmalıdır.
2. Lastikler hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Lastikler yırtılmaya, aşınmaya ve kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

### TATAMI MINDER ( ZEMİN KAPLAMA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toksik madde içermeyen EVA (Etilen Vinil Asetat) köpükten üretilmiş olmalı.
2. Suyu emmemeli ve koku yapmamalı.
3. Kolayca temizlenebilir, su ve sabunla yıkanabilir olmalı.
4. Tatami esnek zemin yer minderleri birbirine geçmeli, kalın ve yumuşak maddeden üretilmiş olmalıdır.
5. Isı ve ses yalıtımı sağlamalı.
6. Elektrik geçirmemeli.
7. Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Turuncu vb. renk seçeneklerine sahip olmalıdır.
8. 100\*100 cm ölçülerinde olmalıdır.
9. Ürünler çift yüzlü olmalıdır.
10. İç içe geçirilebilir özellikte ve kolay kuruluma sahip olmalıdır.
11. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------



## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### BEBEK KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak, Pamuklu kumaş yapısında olmalı
2. Erkek ve kız cinsiyetleri için modellere sahip olmalıdır.
3. Pamuklu olmalıdır.

<b>ÜYE</b> Melek YILMAZ Ebe	<b>BAŞKAN</b> Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	<b>ÜYE</b> Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------