
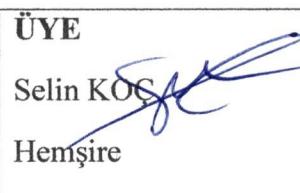


AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


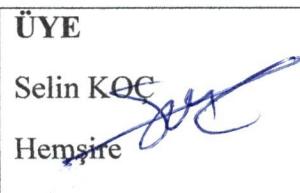
BEZ ÇANTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bez çanta boyutları 35x40 cm ($\pm 0,5$ cm) olmalıdır.
2. Kulp uzunluğu 2,5x70 cm ve siyah renkli olmalıdır.
3. 200 gr ağırlığında olmalıdır ve %100 pamuk ham bez kumaş ve dikişli olmalıdır.
4. Çift yön ve renkli transfer toz baskı olmalıdır.
5. Kalım ve notluk iç cepli dikişli olmalıdır.
6. Çantanın her iki yüzüne yapılacak baskı idare tarafından belirlenecek, numune idare tarafından onaylandıktan sonra üretime geçilecektir.
7. Basım başlamadan önce 1 adet örnek merkezimize getirilerek onay alınmalıdır.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe 	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü 	Selin KOÇ Hemşire 

ŞAPKA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şapkalar kumaştan, cırt bantlı, kuşgözü, köpük siper bulunacak şekilde olmalıdır.
2. Üç ayrı beden seçeneği olmalıdır.
3. Kullanılan tekstil ürünlerinin (kumaş ve boyası) insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermemiği belgelenecektir.
4. Ürünlerin görünür hiçbir bilgesinde gerek yüklenici gerekse üretici logo ve amblemi bulunmayacaktır.
5. Baskı için transfer baskı kullanılacak, güneşé ve suya dayanıklı yıpranmaz ve renkleri solmaz bir kalite ile dikilecek ve bastırılacaktır. Şapkanın üst tarafına baskı gelecektir.
6. Tüm ürünlerin üzerine yapılacak baskı tasarımları ve renk seçimi müdürlük tarafından yapılmış olan seçimlerin dışında olmayacağından emindi.
7. Numune idare tarafından onaylandıktan sonra üretime geçilecektir.
8. Basım başlamadan önce 1 adet örnek merkezimize getirilerek onay alınmalıdır.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe 	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü 	Selin KOÇ Hemşire 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TANITIM BROŞÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. A 4 boyutunda kuşe kağıda olmalı
2. Orta kısım ön yüzünü oluşturmak üzere katlanılır olmalıdır.
3. Çift taraflı olmalı
4. 500 adet olmalı
5. 1.Sınıf basım olmalı
6. Renk gönderilen taslaktaki gibi olmalı

Basım başlamadan önce 1 adet örnek müdürlüğümüze getirerek onay alınmalı

ÜYE Melek YILMAZ Ebe	BAŞKAN Dr. Baran DEMİR TAŞ İlçe Sağlık Müdürü	ÜYE Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	--	------------------------------------

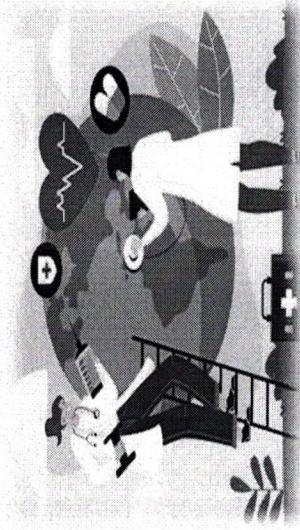
HAKKIMIZDA

Sağlığınız için
çalışıyoruz...

Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hizmet vermektedir.

kuruluşuyuz.

Kurumumuzdaki verilen hizmetler ücretlidir.



AİLE HEKİMLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE
BULUNABILİRSİNİZ.

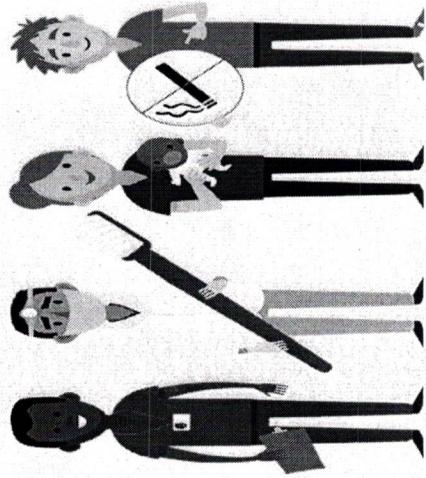
Bize Ulaşın

Adres: Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi No:118

Diyadin/AGRI

Tel:(0472) 511 4650

e-mail:tsm.diyadin@gmail.com



T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIYADIN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



DIYADIN İLÇE SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ

TANITIM BROŞÜRÜ

HİZMETLERİMİZ

- Kanser Erken Teshis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETTEM)
 - Meme Kanseri Taraması
 - Rahim Ağzı Kanseri Taraması
 - Kalın Bağırsak Kanseri Taraması
- Hasta Hakkları Birimi
- Kadın ve Üreme Sağlığı Dayanışma Birimi
- Üreme Sağlığı Danışmanlığı
- Gebe Bilgilendirme Smifii
- Evlilik Öncesi Danışmanlığı
- Çevre Sağlığı Birimi
- Toplum Sağlığı Birimi
- Okul Çağ İşitme Tarama Programı
- Okul Çağ Koruyucu Ağzı ve Diş Sağlığı Programı
- Sağlıklı Beslenme Eğitimi Programı
- Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
- Aşı Birimi
- Desteç Hizmetleri Birimi
- Obezite Birimi
- Aile Hekimliği Birimi

HASTA HAKKLERİ BİRİMİ

Hastalarımızın dilek, öneri ve şikayetlerini rahatlıkla bildirebilmeleri için İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 1 ve 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezleri'nde bire bir adet dilek öneri kutusu bulunmaktadır.

KETEM BİRİMİ

- 30-65 yaş grubundaki kadınlarda Rahim ağzı kanser tarama testi
- 50-70 yaş arası kalın bağırsak kanseri tarama testi
- 20 yaş üstü kadınlara meme muayenesi yapılmaktadır.

KADIN ÜREME SAĞLIĞI VE DAYANIŞMA BİRİMİ

Evlilik öncesi danışmanlık ve gebe sınıfında düzenli eğitim verilmektedir.

DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

İmmobil (yatallaş) hastaların ambulans sevkleri ile vatandaşların rapor itraz talepleri alınıp ilgili kurumlara bildirilmektedir.

ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri; üretim, dağıtım ve satış yerlerinin denetimleri ile su numunesi alım gerekli analizleri yapılmaktadır.

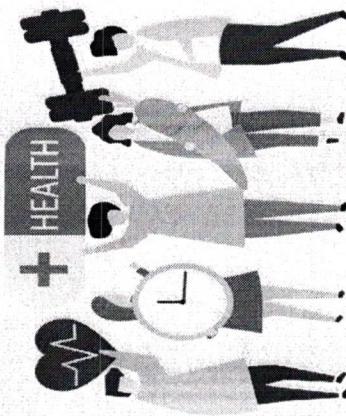
TOPLUM SAĞLIĞI BİRİMİ

Okul sağlığını korunması, geliştirmesi için öğrencilere düzenli eğitim verilmekte, ilkokul 1.sınıf öğrencilerine iştirme tarama testi yapılmaktadır.



AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

Aile Hekimlerinin saha çalışmaları; geçici ve yerinde sağlık hizmetlerinin planlanması ve takip edilmesi sağlamakta olup vatandaşın istediği hekimi seçme işlemleri yapılmaktadır.



BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ

Bulaşıcı Hastalıklar ile ilgili verilerin toplanması, analizi, geri bildirimlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütüp bu konularda halka eğitim verilmektedir.

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GLUKOSTIK (STRIP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Garanti belgesi olmalıdır.
2. Stripler Glukometre ile uyumlu olmalı, kod okutmaya gerek duyulmamalıdır.
3. Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilmelidir.
4. Striplerin son kullanım tarihi her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde olmalıdır.
5. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az iki raf ömrü olmalıdır. İhaleyi kazanan firma mevcut stripelerin kullanılamaması durumunda son kullanım tarihine en az üç ay kala durumun firmaya yazılı olarak bildirilmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirme garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir.
6. Ölçüm sonuçları tutarlı, klinik bulgular ile uyumlu olmalıdır.
7. Stripler 15-40 C sıcaklıkta güvenilir sonuçlar vermelidir.
8. Striplerin ölçüm aralığı en az 20-600 mg/dl arasında olmalıdır.
9. Stripler kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal tam kanörneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir.
10. Striplerde görsel kontrol de mümkün olmalıdır.
11. Stripler %20-70 hematokrit aralığında güvenli sonuç vermelidir.
12. Stripler 2 mikro litre gibi çok az bir kanla çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Striplere kan damlatıldıkten sonraki en geç 10 saniye gibi kısa sürede cihaz kan şekeri sonuçlarını ekranında verebilmelidir.
14. Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
15. Kan stribi kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.
16. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir. İnce olmamalı, kırılıp bükülmemelidir.
17. Stripler nem, ısı ve ışıktan korunaklı ambalajlarda olmalıdır.
18. Stripler tek tek ambalajlanmışsa en fazla 100 adetlik, tek tek ambalajlanmamışsa en fazla 50 adetlik paketler halinde olmalıdır.
19. Her 500 strip başına bir glukometre cihazı verilmelidir. Cihaz stripler ile uyumlu olmalıdır.
20. İhale süresine bakılmaksızın ölçüm çubukları bitinceye kadar, cihazların bakım, onarım ve pil değişimi firma tarafından yapılacaktır.
21. Numuneler ihale esnasında, getirilip birim tarafından denedikten sonra karar verilecektir. Numune getirmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22. Titubb (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) Barkod Sut ve Sut alan kodlarından kaynaklanan zararlar ve kesintiler yüklenici firmaya aittir.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMIRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOC Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık en az (30 g) uçlu ince tip olmalıdır.
2. Delici metal uç plastik gövdeye yerleştirilmiş olmalı ve delici uç ayrı bir plastik parça tarafından korumalı olmalıdır.
3. 100 lük ambalajlarda olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
5. Uç delici kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.
6. Ürün CE belgeli olmalıdır.
7. Otomatik delici lanset kalemlere uyumlu olmalıdır.
8. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miadlı olmalıdır. Miadı içerisinde tüketilemeyen ürün en az 3 ay öncesi bildirim yapıldığında, uzun miadlı yeni ürünle değiştirilmelidir.
9. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise belirtilmelidir.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOC Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ ATIK TULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Turuncu renkte olmalıdır.
2. Tulum şeklinde olmalıdır.
3. Yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır.
4. Polo yaka olmalı ve uzun düz kollu olmalıdır.
5. Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilecektir.Ölçülere idare karar verecektir.
6. Tulum arka kısmında “ULUSLARARASI BİOTEHLİKE AMBLEMİ” İLE “DİKKAT TIBBİ
7. ATIK” yazısı baskısı olacaktır.İdarenin isteğine bağlı olarak ön kısmında üst cebin üstüne ‘TIBBİ
8. ATIK PERSONELİ” yazısı eklenebilir.
9. Tıbbi atık kıyafeti standart tulum şeklinde hazırlanmalıdır.
10. Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup,yırtılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez olacak,tulum yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak.
11. Belde yarınlastik ,kaliteli fermuarlı olacak.
12. Kollar düz olacak.
13. İthal polyester gabardin(%65 pamuk,%35 polyester) kumaş kullanılacak.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ ATIK ÇİZMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Su geçirmez olacak.
2. İğne batmaz kauçuktan olmalıdır.
3. Diz altı hizasında olmalıdır.
4. Yıkamaya ve kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
5. PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş tabanı sert kauçuktan olmalıdır.
6. Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olmalıdır.
7. İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyecek yapıda olmalıdır.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TİBBİ ATIK ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır.
2. Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak.
3. Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak.
4. Üstü tamamen kaplı, iç astarı kaliteli olacak.
5. Rengi turuncu olacak.
6. Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek, kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdır.
7. Tıbbi atık eldiveni CE ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
8. Eldivenler kaliteli kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
9. Kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Kaymayı engellemek için eldivenin üzeri tırtıklı olmalıdır.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMIRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TİBBİ ATIK KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) imal edilecektir.
2. Konteyner TS EN 840 Standardına uygun olacaktır.
3. Konteynerlerin tekerlek gövdeleri polipropilen ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartlarına dayanıklı mamülden yapılmış olacaktır.
4. Tekerlek aks mili galvaniz kaplı veya paslanmaz malzemeden olacaktır.
5. Konteyner hacmi 770-800 Lt kapasiteli olmak üzere 4 tekerlekli ve üstten kapaklı olacaktır.
6. Konteynerlerin tekerlek dönüşleri kolay olacak, genel anlamda konteyner rahat taşınabilir olacaktır.
7. Konteynerler koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, güneş ısısından etkilenmeyecek aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
8. Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak ve bu şok etkisinde hiçbir deformasyon ölçü ve diğer özelliklerinde değişiklik olmayacağından emindi.
9. Konteynerlerin gövdeleri düşmeye karşı dayanıklı olacak, sızma, çatlama ve yarıılma göstermeyecektir.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4' LÜ SIFIR ATIK KUMBARALARI VE POŞETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

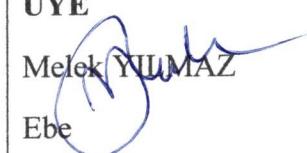
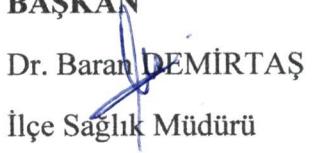
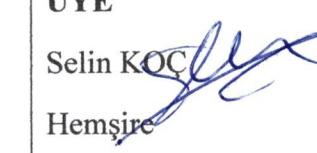
1. Plastik 4'lü set halinde olmalıdır.
2. Atık kumbaraları cam atık, kağıt atık, plastik atık ve metal atık türleri için olmalıdır.
3. Kalın kırılmaz plastikten olmalıdır.
4. Ölçüleri 35*35*70 cm olmalıdır.
5. Her kutunun üstünde hangi atığın atılacağına dair yazı, geri dönüşüm simgesi ve sıfıratık logosu bulunmalıdır.
6. Kağıt atık için mavi; cam atık için yeşil; plastik atık için sarı ve metal atık için gri rengi kullanılmalıdır.
7. Kumbaraların ve poşetlerin üzerinde geri dönüşüm simgesi, sıfır atık logosu kullanılmalıdır.
8. Her kumbara rengi için 150 adet poşet alınmalıdır.
9. Atık poşetleri delinme, yırtılma durumlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
10. Teklif veren firmadan örnek kutu istenilecek ve şartnameye uygun olmaması durumundatarafımızca kabul edilmeyecektir.

ÜYE Melek YILMAZ Ebe	BAŞKAN Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	ÜYE Selin KOÇ Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TANITIM STANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Taşınması, demonte monte dönüşümü kolay olmalıdır.
3. İç gövdesinde 1 (bir) adet raf olmalıdır ve rafin taşıma kapasitesi 5 kg'a kadar dayanıklı olmalıdır.
4. Rengi beyaz olmalıdır.
5. Gövde ve alınlığa basımı yapılacak logo ve yazılar idareden teslim alınacaktır.
6. Plaastik oval tanıtım standı demonte şekli PVC kumaş çanta içerisinde olmalıdır.
7. Ölçüler:
 - En: 80-100 cm
 - Derinlik: 45-50 cm
 - Boy: 90-100 cm
 - Kurulu Yükseklik: 180-200 cm
 - Alınlık: 80-100 cm
 - Alınlık Yüksekliği: 20-25 cm
 - Ağırlık: 5 kg
 - Taşıma Kapasitesi: 15 kg

ÜYE Melek YILMAZ Ebe 	BAŞKAN Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü 	ÜYE Selin KOC Hemşire 
---	---	---

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YER MINDERİ (MAT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. $100(\pm 20) \times 180 (\pm 20)$ cm boyutlarında olmalıdır
2. Fermuarlı, leke tutmaz özelliği olan, dış kılıfı yıkanabilir malzemeden olmalıdır yıkanabilir.
3. İç kılıfı olmalıdır.
4. Pamuklu kumaştan yapılmış olmalıdır.
5. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
6. Rulo haline getirilerek fazla alan kaplamaması ve korunması sağlanabilmektedir.
7. Kullanıma uygun olmayan (ambalaj hatası, uygunsuzluk, kusurlu ürün vb.) ürünler firma tarafından değiştirilebilmeli.
8. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

TENIS TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Topun çapı 6,3-6,8 cm aralığında olmalıdır.
2. Rengi sarı veya beyaz olmalıdır.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PILATES TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çapı 65 cm olmalıdır.
2. Yumuşak renkli, elastik malzemeden imal edilmiş olmalı
3. Pilates topları kol ve bacak egzersizleri ve rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
4. Pilates toplarının üzerine basınç bindiği zaman dereceli olarak artan bir direnci olmalıdır.
5. 24 ay garanti süresi bulunmalıdır.
6. Paket içerisinde el pompası olmalı ve bu pompa topu pratik bir şekilde şişirebilmelidir.
7. Pilates topunun delinmesi durumunda havasının yavaş yavaş inmesini sağlayacak ABS sistemi olmalıdır.
8. Toplar şişmiş olarak teslim edilmelidir.
9. Teslimat öncesinde numune görülecektir.
10. Rengi gri veya pembe olmalıdır. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

AYAKLI YAZI TAHTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüzeyi Emaye ve silinebilir olmalıdır.
2. Çevresi alüminyum çerçeve ile kaplanmış olmalıdır
3. 60(± 10) x 90 (± 10) cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Teleskopik ayaklı ve ayaklar ayarlanabilir olmalıdır.
5. Beyaz renk olmalıdır.
6. Ürün kalemleri ve silgisi ile birlikte verilmelidir.
7. Kalem ve silgi için alt tarafında yeri olmalıdır. En az 2 yıl garanti olmalıdır

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YASTIK (KÜÇÜK/BÜYÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Büyuk yastık ölçüsü $50(\pm 10) \times 70(\pm 10)$ cm ölçülerinde, küçük yastık ölçüsü: $35(\pm 10) \times 35(\pm 10)$ cm olmalıdır.
2. Şilte kumaşı %100 pamuk olmalıdır.
3. Dış kılıfında fermuar olmalıdır.
4. Dış kılıfı yıkanabilir malzemeden olmalıdır.
5. Yastık içerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalıdır.
6. Ürün içerisindeki boncuk silikon elyaf, yıkama veya kullanma esnasında keçelesme ve topaklanma yapmamalıdır.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOC Hemşire

BEBEK HAVLUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
2. $90(\pm 10) \times 90(\pm 10)$ cm ebatında olmalıdır.
3. Beyaz olmalıdır.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOC Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BEBEK BATTANIYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
2. 90(±10) x 90(±10 cm) ebatında olmalıdır.
3. Yıkanabilir olmalıdır.
4. Ürünün kenarları 3cm'lik biye ile veya kenarları içe katlamalı şekilde çift kat olarak dikilecektir.
5. Rengi krem olmalı

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

BEBEK MASAJ YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bebek cildi için özel olarak geliştirilmiş olmalıdır.
2. Nemlendirme sağlamalıdır.
3. Bebek masajı için kullanılabilir olmalıdır.
4. Hipoalerjenik olmalıdır.
5. İnsan sağlığına zararlı bileşen içermemelidir.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BEBEK KIYAFETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Yumuşak, Pamuklu kumaş yapısında olmalı
2. Erkek ve kız cinsiyetleri için modellere sahip olmalıdır.
3. Pamuklu olmalıdır.

ÜYE Melek YILMAZ Ebe	BAŞKAN Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	ÜYE Selin KOC Hemşire
-----------------------------------	---	------------------------------------

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BEBEK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Emici olmalı yanlardan sızdırma yapmamalıdır.
2. Yanlarda yapıştırma bantları olmalı açılıp kapandıktan sonra tekrar yapıştırılabilmelidir.
3. Yanları sert olmamalı bebeğin cildini tahriş etmemelidir.
4. Yenidoğan boyutlarında (3-6 kg) olmalıdır.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe 	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü 	Selin KOÇ Hemşire 

DUMBELL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 set ağırlık içinde
 - 0,5 kg dumbell 1 adet
 - 1 kg dumbell 1 adet
 - 2 kg dumbell 1 adet
2. Dumbellar metal üzeri vinil kaplı dumbell olmalıdır.
3. Dumbelllerin görünebilir yerinde ağırlık kilogramları yazılı olmalıdır.
4. Dumbelllerin kolay ayırt edilebilmesi için her ağırlığın rengi farklı olmalıdır.
5. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe 	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü 	Selin KOÇ Hemşire 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

EGZERSIZ DIRENÇ LASTİĞİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak, orta ve sert şeklinde 3'lü set halinde olmalıdır.
2. Lastikler hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Lastikler yırtılmaya, aşınmaya ve kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire

TATAMI MINDER (ZEMİN KAPLAMA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toksik madde içermeyen EVA (Etilen Vinil Asetat) köpükten üretilmiş olmalı.
2. Suyu emmemeli ve koku yapmamalı.
3. Kolayca temizlenebilir, su ve sabunla yıkınabilir olmalı.
4. Tatami esnek zemin yer minderleri birbirine geçmeli, kalın ve yumuşak maddeden üretilmiş olmalıdır.
5. Isı ve ses yalıtımlı sağlamalı.
6. Elektrik geçirmemeli.
7. Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Turuncu vb. renk seçeneklerine sahip olmalıdır.
8. 100*100 cm ölçülerinde olmalıdır.
9. Ürünler çift yüzlü olmalıdır.
10. İç içe geçirilebilir özellikte ve kolay kuruluma sahip olmalıdır.
11. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

ÜYE	BAŞKAN	ÜYE
Melek YILMAZ Ebe	Dr. Baran DEMİRTAŞ İlçe Sağlık Müdürü	Selin KOÇ Hemşire